



***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
calentadores de suero para área quirúrgica del HUB, OSI
Bilbao Basurto
2022/01823***

SUMARIO

I. Objeto.....	2
II. Prescripciones generales.	2
III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	3



I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el procedimiento que se convoca para el **Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HuB, OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Descripción del material	Uds	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)	Total licitado (con IVA)
1	Calentador de sueros	6	4.085,00 €	24.510,00 €	29.657,10 €
Total Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HuB, OSI Bilbao Basurto				24.510,00 €	29.657,10 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Prescripciones generales.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de "Especificaciones Técnicas". Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto, y toda aquella documentación/información que el licitador considere oportuno para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.



III. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento denominado "Prescripciones técnicas mínimas". Para ello, siguiendo el guion indicado a continuación, indicarán la siguiente información

- Columna A: Característica mínima exigida.
- Columna B: Cumple: si/no.
- Columna C: Justificación del cumplimiento.
- Columna D: Referencia a la página de su oferta en la que se acredita el cumplimiento.

La ausencia de cualquiera de esta información será motivo de exclusión. Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma. El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación.

Requisitos mínimos Exp 2022/01823 Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HUB, OSI Bilbao Basurto	
Lote 1 Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HUB, OSI Bilbao Basurto	
1.	Capacidad para 35 ± 2L
2.	Regulador por microprocesador y control por pantalla táctil
3.	Cubeta recinto acero inoxidable,
4.	Cámara de precalentamiento acero inoxidable
5.	Puerta de cristal templado
6.	Elementos calefactores distribuidos de forma homogénea
7.	Aislamiento térmico en las paredes de la cámara
8.	Grupo motor ventilador para la circulación forzada del aire, con turbina en acero inoxidable
9.	Cámara independiente para los elementos de regulación y control
10.	Dispositivo de aireación con salida regulable
11.	Dispositivo para guías bandejas regulable en altura


Requisitos mínimos Exp 2022/01823 Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HUB, OSI Bilbao Basurto

Lote 1 Suministro de calentadores de suero para área quirúrgica del HUB, OSI Bilbao Basurto

- | |
|--|
| 12. Bandejas de rejilla en acero inoxidable |
| 13. Temperaturas regulables desde +5° C hasta 250°C |
| 14. Estabilidad: $\pm 0,3$ °C, a 100 °C. Homogeneidad: ± 1 °C, a 100 °C. |
| 15. Error de $\pm 2\%$ a temperatura de trabajo. resolución: 1 °C |
| 16. Rampas de temperatura programables |
| 17. Diferentes alarmas acústicas y visuales (temperaturas, memorización, puerta abierta...) |
| 18. Autodiagnóstico |
| 19. Cumplimiento Norma EN 61010 Limitador fijo de sobrecalentamiento incorporado |
| 20. Cumplimiento Norma DIN 12880 (clase 2 y 3.1) Termostato de seguridad regulable incorporado |

Cada calentador de suero se suministrará con 4 guías y 2 bandejas.

En Bilbao, a 17/06/2022

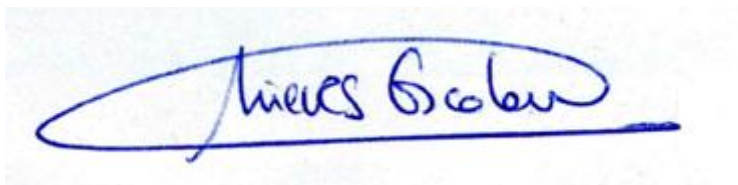

Fdo.: Nieves Escolano Picado
Baliabide Materialen Gainbegirale Kudeatzailea
Supervisora de Recursos Materiales
Bilbo Basurtuko ESI
OSI Bilbao Basurto